БЛОКИ ПИТАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРЭМ

(справочное)

Для питания электромагнитных преобразователей расхода ПРЭМ разрешается использовать следующие импульсные источники вторичного электропитания: 10ВР220-12Д, DRC-12V10W1AZ, ИЭС18-126150, ИЭС6-126050, AMRI-12, БП12-12.

Для расходомеров ПРЭМ с управляющей платой 2022/3523 допускается применение импульсных источников вторичного электропитания с выходным напряжением 24 В, при условии соответствия их параметров требованиям, указанным в паспорте прибора.

Характеристики, относящиеся к монтажу и подключению блоков питания (рис. 1).


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ПРИБОРА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ К ОДНОМУ БЛОКУ ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ!


Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм

Подключение через винтовые клеммы


Монтаж




10ВР220-12Д



DRC-12V10W1AZ

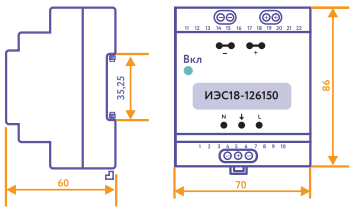

ИЭС18-126150



ИЭС6-126050


Подключение














AMRI-12



БП12-12





YSD15S-1200830




ИЭС6-120081

Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм

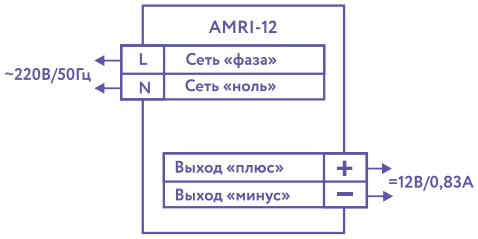

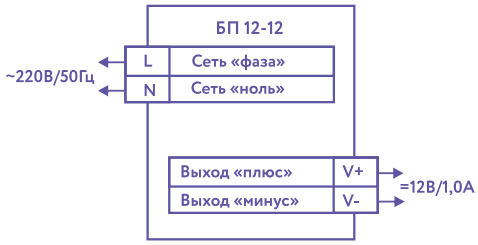

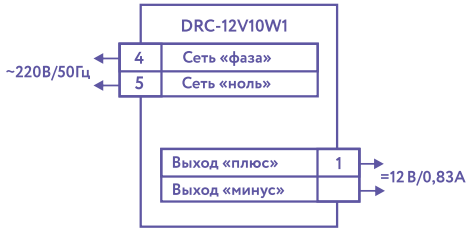



Подключение через винтовые клеммы

Рисунок 1 Характеристики при подключении и монтаже блоков питания

ПРЭМ

www.teplocom-sale.ru

8 800 250 03 03

197348, Россия, Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, дом № 10, литера АФ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТЕПЛОКОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ В RUSTORE

ТЕПЛОКОМ

С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА БУДУЩЕЕ